



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΠΕ

Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΘ

6^η ΥΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"
Αρ. Πρωτ. 48137/6111/2023

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΟΙΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΤΡΑ 30/10/2023

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ

Τα φίλτρα πρέπει να πληρούν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:


1. Να είναι υδρόφοβα, μηχανικά (πτυχόμενης μονής μεμβράνης), ενηλίκων
2. Να είναι αντιμικροβιακά-αντιϊκά
3. Να είναι εναλλάκτης ύγρανσης-θέρμανσης
4. Να κατακρατούν $\geq 99,9999$ % των μικροβίων και ιών σε κλινικό περιβάλλον
5. Να έχει νεκρό όγκο ≤ 70 ml
6. Να είναι ελαφρά με βάρος ≤ 40 g
7. Να έχει αντιστάσεις ροής ≤ 3 cm H₂O στα 60L/min
8. Να έχει απόδοση ύγρανσης ≥ 25 mg/L σε αναπνεόμενο όγκο 500ml
9. Να είναι απαλλαγμένο latex και PVC, με διαφανές περίβλημα
10. Να έχει οπή καπνογραφίας, καπάκι και θηλιά συγκράτησης, για αποφυγή απώλειας και διασποράς
11. Να συστήνεται με εύρος αναπνεόμενων όγκων από 180ml-1300ml
12. Να είναι σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένο για χρήση σε έναν ασθενή
13. Να είναι συμβατά για συνδεσμολογία 22M/15F-22F/15M
14. Να αναφέρεται ενδεικνυόμενη διάρκεια χρήσης
15. Να αναφέρεται η κλάση στην κατηγορία φίλτρου HEPA (ή να αναφέρεται το HEPA CLASS TEST)
16. Να κατατίθεται επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστή για πιστοποίηση των ανωτέρω καθώς και σχετική βιβλιογραφία (εάν διατίθεται)
17. Να φέρουν κωδικό CE και ISO
18. Θα ζητηθεί αν κριθεί αναγκαίο και αντίστοιχο δείγμα

Ποσότητα 500 τμχ.

Συνολικό κόστος περίπου €2.000 επιπλέον Φ.Π.Α.

Τα μέλη της επιτροπής προδιαγραφών

Πέτσας Ανδρέας

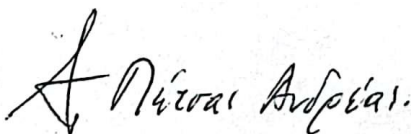

Αναστογιάννης Χαράλαμπος



Καρατσικάκης Απόστολος

